Separación de Bases Nucléicas a pH 4 y pH 5 en OBELISC N

Columna:	**OBELISC N**
Dimensiones:	150x4.6mm
Caudal:	1.0 mL/min
Fase Móvil:	Ver
Detector:	UV 250 nm

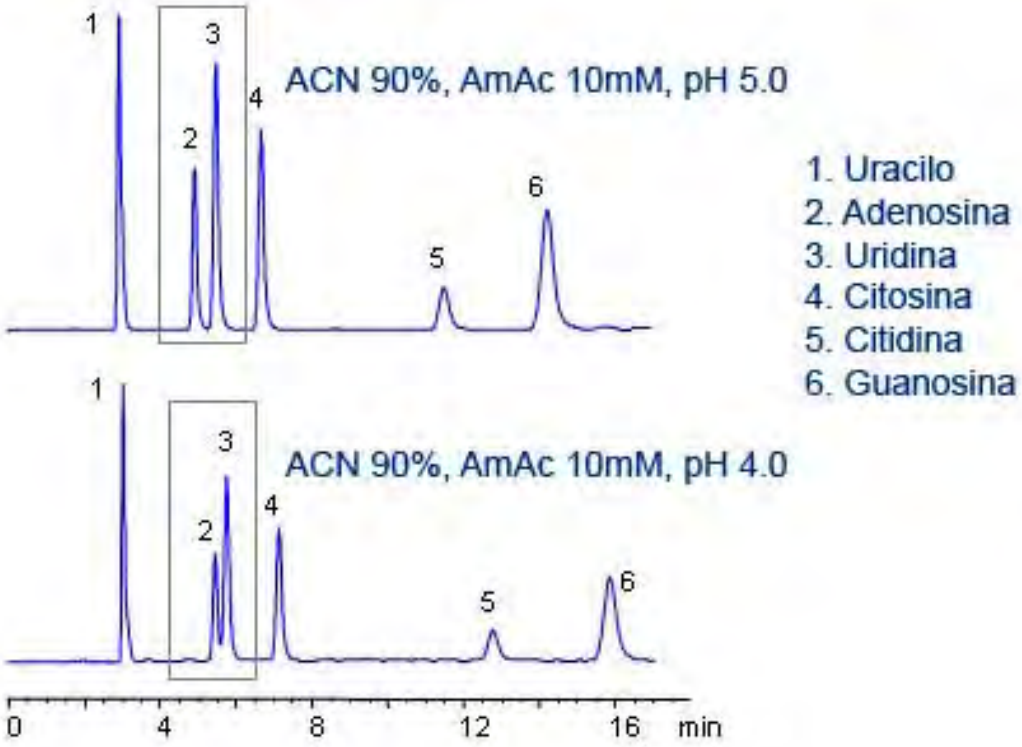

Notas de Aplicación:

Uracilo, Adenosina, Uridina, Citosina, Citidina, Guanosina, Uracil, Adenosine, Uridine, Cytidine, Guanosine, SIELC, HPLC, HILIC, Obelisc N

CromLab S.L., Acer 30-32, 08038 Barcelona. Tel 932233319, FAX 932231637, Email: comercial@cromlab.es Internet: www.cromlab.es
Copyright 2003-2009. SIELC Technologies Inc. All rights Reserved